


For a correctly sized printout, adjust Adobe Acrobat Reader's Print Menu settings as shown here:

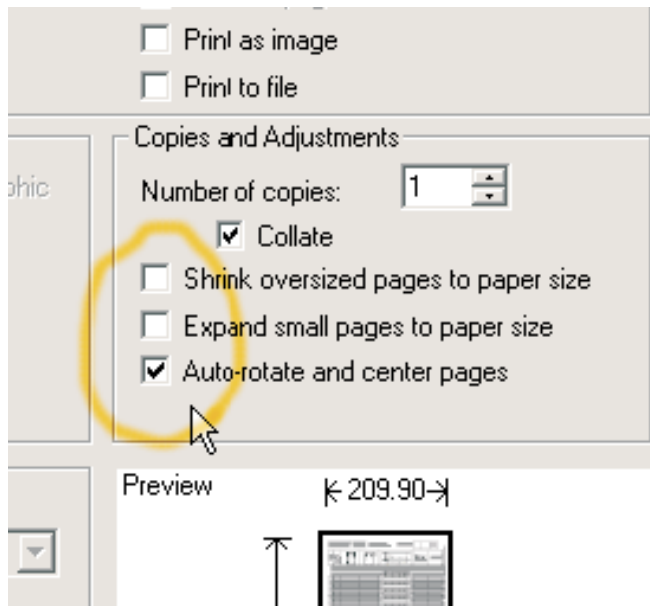

Using these settings, print only page 2 and/or 3 of this document.

ThromboType® 12

VER 2.0

00241-0507-02-6

dd	mm	yyyy

#			
---	---	---	---



FV-G1691	FVL-1691A	FIL-G20210	FIL-20210A
----------	-----------	------------	------------

--	--	--	--

--

--	--	--	--

--	--	--	--

--

--	--	--	--

--	--	--	--

--

--	--	--	--

--	--	--	--

--

--	--	--	--

--	--	--	--

--

--	--	--	--

--	--	--	--

--

--	--	--	--

--	--	--	--

--

--	--	--	--

--	--	--	--

--

--	--	--	--

--	--	--	--

--

--	--	--	--

--	--	--	--

--

--	--	--	--

--	--	--	--

--


--	--	--	--

--	--	--	--

--

--	--	--	--

LOT _____
  HYB _____ min
  STR _____ min
  SUB _____ min



ThromboType® 96

VER 2.0

00241-0507-03-5

dd	mm	yyyy

#	(Blood Test)	(Patient)	(Lab Technician)
---	--------------	-----------	------------------



FV-G1691	FVL-1691A	FIL-G20210	FIL-20210A
----------	-----------	------------	------------

LOT _____
 HYB _____ min
 STR _____ min
 SUB _____ min